

La peur de
la douleur = le frein N°1

des patients face aux injections

Etude Consommateurs Ispos, 2008

TEOSYAL PureSense

ACIDE HYALURONIQUE + LIDOCAINE
EFFICACITE • SECURITE • DURABILITE CONFORT OPTIMAL

... = SATISFACTION PATIENT ...



9 patients sur 10

ont trouvé l'injection de TEOSYAL® PureSense **significativement moins douloureuse qu'avec un produit sans lidocaïne***.

99% des patients injectés

avec la gamme TEOSYAL® PureSense **sont prêts à se faire ré-injecter***.

* Etude multicentrique France 2010 réalisée sur plus de 30 patientes par les Docteurs Trevidic et Claude spécialistes en Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique.



L'offre la plus complète sur le marché des implants de comblement et volumateurs avec lidocaïne

TEOSYAL PureSense Ultra Deep
Le remodelage en douceur

TEOSYAL PureSense Kiss
L'embellissement des lèvres

TEOSYAL PureSense Deep Lines
La correction en profondeur

TEOSYAL PureSense Global Action
Le comblement simplifié

TEOSYAL PureSense First Lines
La correction des rides superficielles

Résultats Immédiats et Durables

●●● Sillons nasogéniens PureSense Deep Lines
Injection d'1 seringue de 1ml



●●● Sillons nasogéniens, plis d'amertume PureSense Ultra Deep
Injection de 2 seringues de 1ml




Des résultats cliniquement prouvés


●●● METHODOLOGIE

- Etude multicentrique, Dr Trevidic et Dr Claude (France, 2010)
- 32 patients
- Injection en héli-visage des sillons nasogéniens avec TEOSYAL® PureSense vs TEOSYAL®
- Evaluation de la douleur mesurée par l'échelle internationale EVA*

●●● DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS SUR LA DIMINUTION DE LA DOULEUR

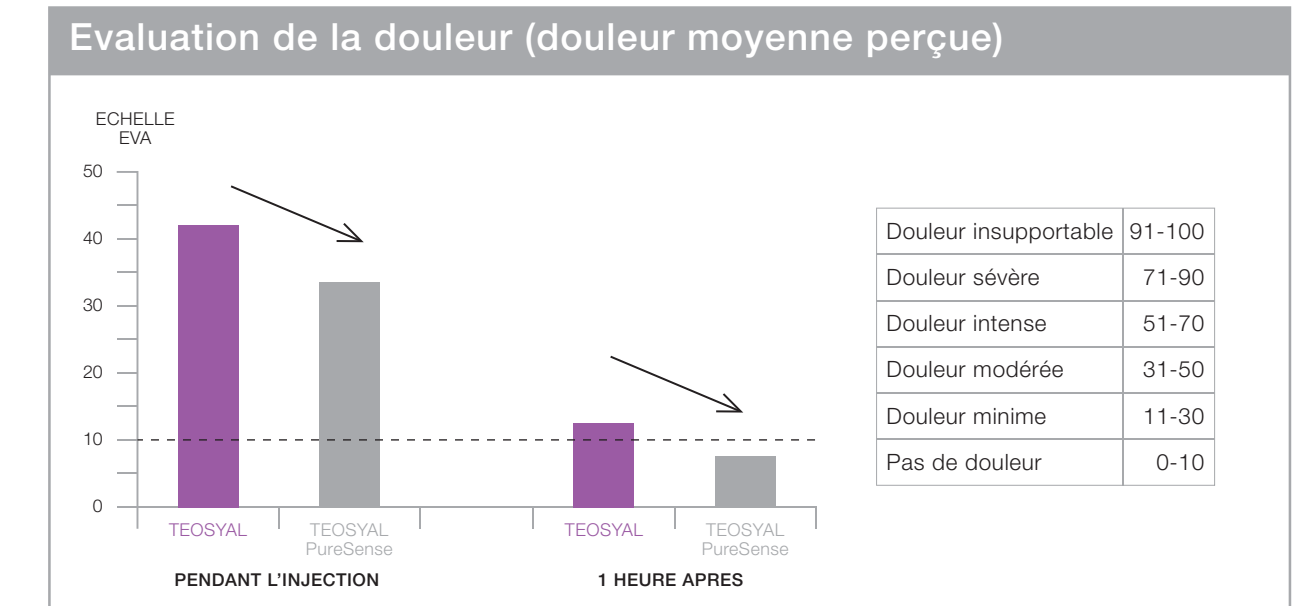

Une durabilité optimisée

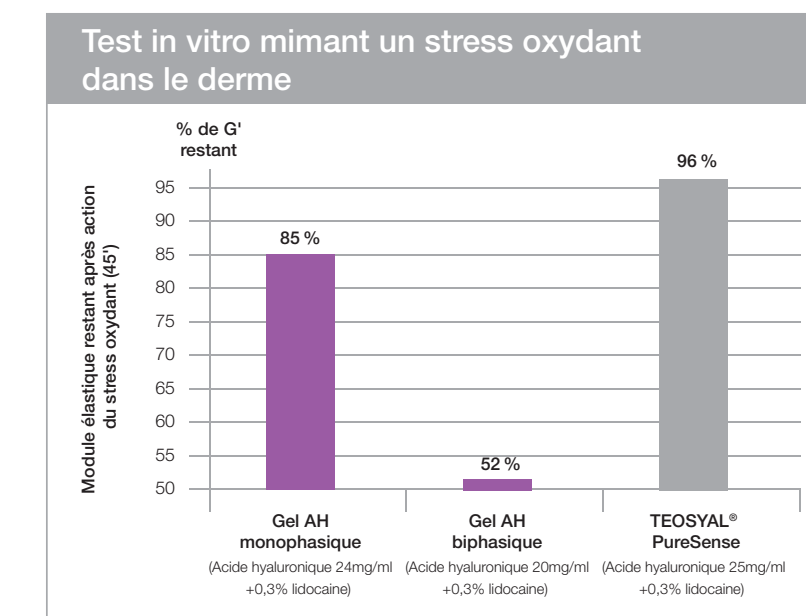

• Au moment de l'injection, les gels d'acide hyaluronique sont soumis à un fort stress oxydant dans la peau (réponse inflammatoire) entraînant une dégradation plus rapide du produit.

• Le savoir-faire des Laboratoires Teoxane dans la fabrication des implants à base d'acide hyaluronique a permis de développer des **produits TEOSYAL® PureSense offrant une meilleure résistance au stress oxydant** comparativement à d'autres implants de comblement contenant la même concentration en lidocaïne.

*Echelle Visuelle Analogique